
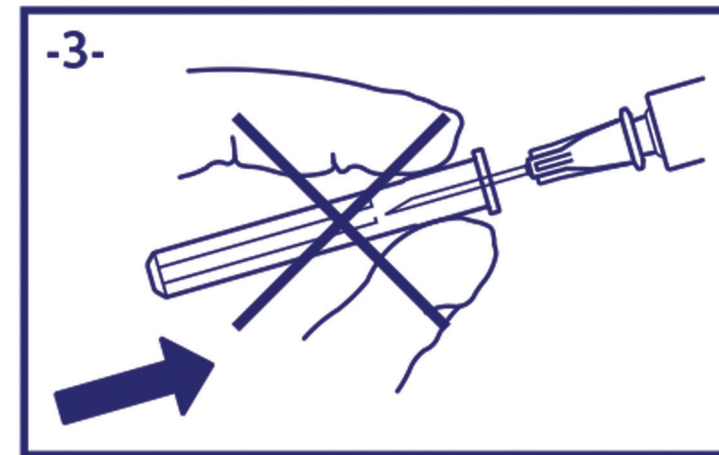
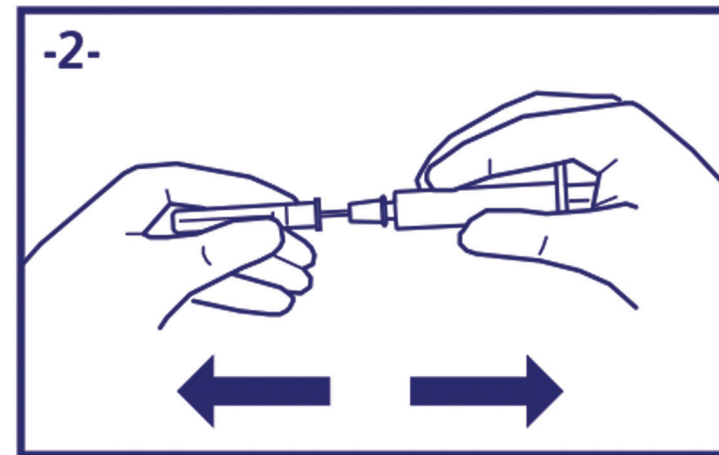


ATTENTION: Les aiguilles, après utilisation, peuvent être contaminées. Les éliminer conformément aux réglementations en vigueur propres à chaque pays et à chaque établissement. La réutilisation peut provoquer une infection ou d'autres maladies/préjudices.

DGF341 REV.#: 05

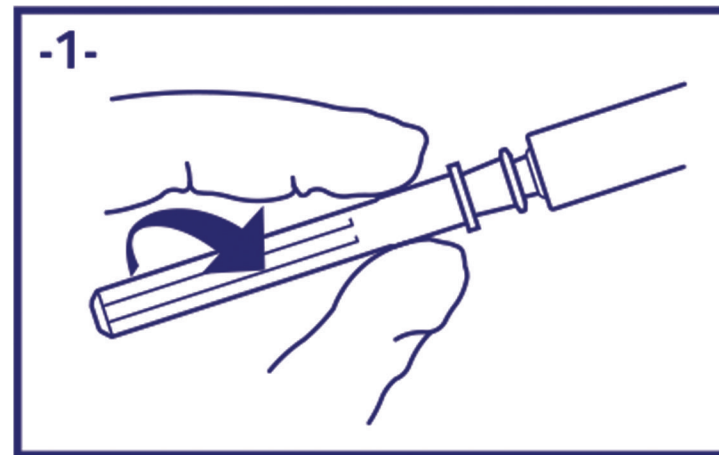

 Becton Dickinson S.A.,
Carretera Mequinenza, s/n,
22520 Fraga

STERILE **EO**

CE 0318



Date de rédaction interne 10/07/2025